



ДЕПАРТАМЕНТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ, ОБОРОННОЇ РОБОТИ
ТА ВЗАЄМОДІЇ З ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ПРОТОКОЛ
ЩОДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ УПОВНОВАЖЕНОЮ ОСОБОЮ

03.11.2023 р.

м. Черкаси

Керуючись вимогами Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон), Положенням про уповноважену особу, іншими Законами України та у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», на підставі ст. 25 Закону України “Про публічні закупівлі”

ВИРІШИВ:

1. Замовником прийнято рішення про внесення змін до тендерної документації по закупівлі УА-2023-10-27-012115-а, а саме до Додатку 1 Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі: Дозиметр-радіометр (для визначення потужності експозиційної дози) «ДК 021:2015:38340000-0: Прилади для вимірювання величин, додати пункти:

- Наявність чохла для кріплення на пояс/ремінь;
- Наявність розкладної штанги довжиною не менше 30 см, з тримачем для дозиметра

2. Додатк 1 Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі: Дозиметр-радіометр (для визначення потужності експозиційної дози) «ДК 021:2015:38340000-0: Прилади для вимірювання величин, викласти в новій редакції:

3.

Додаток 1

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі: Дозиметр-радіометр (для визначення потужності експозиційної дози) «ДК 021:2015:38340000-0: Прилади для вимірювання величин

2.

№ з\п	Найменування товару	Од. вим.	К-сть
1	Дозиметр-радіометр	шт	100

Технічні вимоги

- Типи вимірювальних випромінювань: Рентгенівське, Гамма, Бета;
- Діапазон вимірювання потужності амбієнтного еквівалента дози (ПЕД): 0,01 мкЗв/год – 10 мЗв/год;
- Діапазон вимірювання амбієнтного еквівалента дози (ЕД): 0,01 мкЗв - 9999 Зв;
- Енергетичні діапазони вимірювання: 40 кеВ - 3,0 МеВ;
- Наявність пошукового режиму – індикація кількості імпульсів з секунду;

- Відносні похибки енергетичної залежності (^{137}Cs): $\leq \pm 25\%$;
- Основні відносні похибки: $\leq \pm 10\%$ (при 20 мкЗв/год);
- Діапазон регулювання порогового рівня сигналізації відносно потужності дози випромінювання: регулюється в межах діапазону;
- Діапазон регулювання порогового рівня спрацювання сигналізації відносно дози випромінювання: регулюється в межах повного діапазону;
- Час спрацювання сигналізації при перевищенні фонових значення в 10 разів: ≤ 6 секунд;
- Одиниця виміру:
ПЕД: (мкЗв/год, мЗв/год, Зв/год),
ЕД: (мкЗв, мЗв, Зв);
- Живлення: дві батарейки типу ААА; відображення заряду батареї
- Розмір: 125x55x26 (мм);
- Вага: 100 г (без батарейок).


Функції

- Сигналізація перевищення запрограмованих порогових рівнів;
- Фіксація максимального значення ПЕД;
- Годинник і будильник;
- Світлова індикація ресстрації імпульсів: подання світлових сигналів різної частоти залежно від сили випромінювання – чим сильніше випромінювання, тим вища частота;
- Наявність чохла для кріплення на пояс/ремінь;
- Наявність розкладної штанги довжиною не менше 30 см, з тримачем для дозиметра.

**В разі наявності в даному документі посилань на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, після такого посилання слід вважати в наявності вираз «або еквівалент».*

3. Інформацію про внесення змін до технічної документації, пререлік змін та тендерну документацію в новій редакції оприлюднити в електронній системі закупівель.

Уповноважена особа

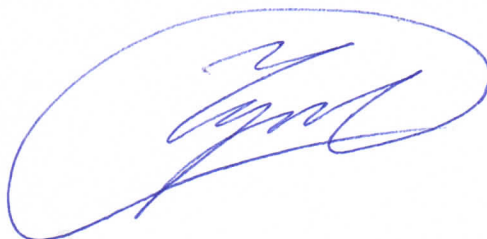

Дмитро ЧУХРІЙ